


# Grafik 1: Implantatregister SIRIS Hüfte und Knie - Hüftprothetik

ANQ-Kommentar zum  
dargestellten Vergleich  
(Grafik 1)

Diese Grafik zeigt die  
adjustierte 2-Jahres-  
Revisionsrate im Zeitraum  
vom 1.1.2016 bis 31.12.2019 bei  
primären Hüfttotalprothesen  
mit primärer Arthrose.  
Die 2-Jahres-Revisionsrate lag  
durchschnittlich bei 2.6%.

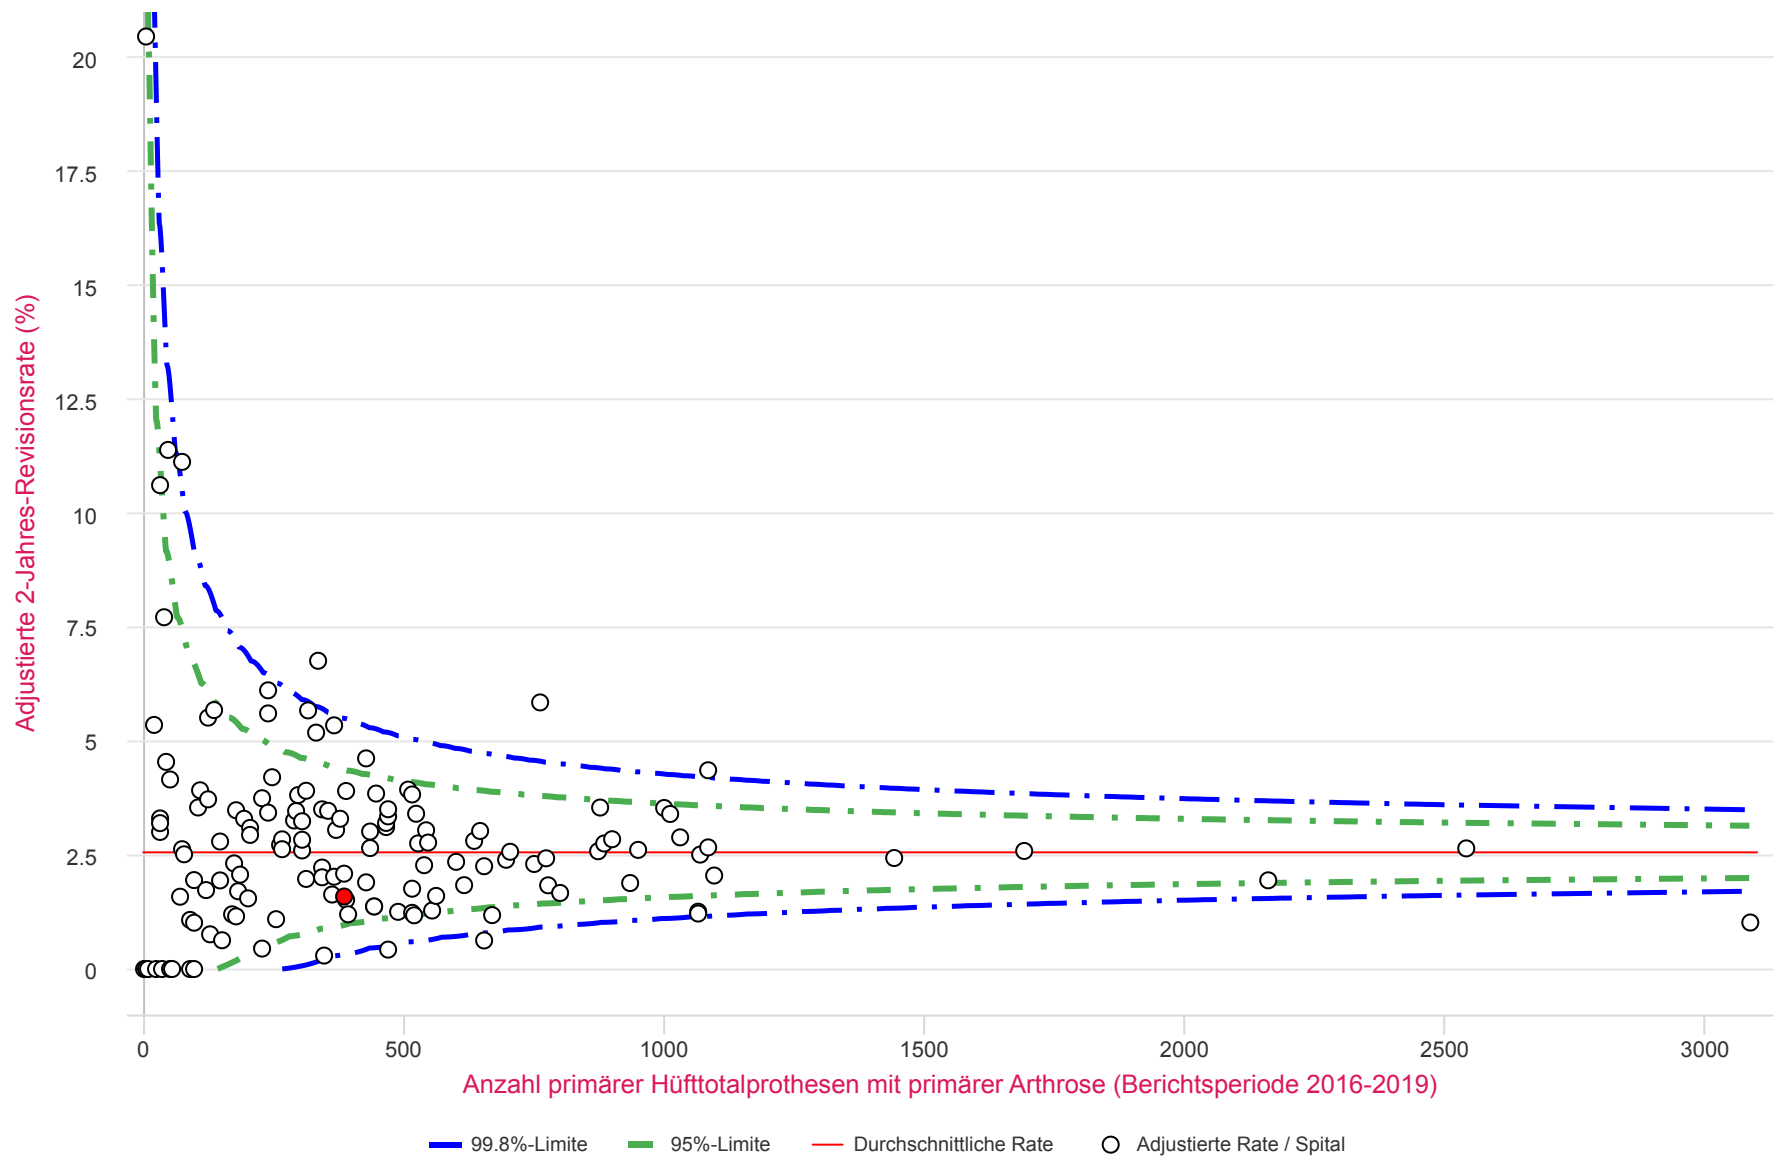

— 99.8%-Limite    - - 95%-Limite    — Durchschnittliche Rate    ○ Adjustierte Rate / Spital