


# Grafik 2: Implantatregister SIRIS Hüfte und Knie - Knieprothetik

ANQ-Kommentar zum  
dargestellten Vergleich  
(Grafik 2)

Diese Grafik zeigt die  
adjustierte 2-Jahres-  
Revisionsrate im Zeitraum  
vom 1.1.2016 bis 31.12.2019 bei  
primären Knie totalprothesen  
mit primärer Arthrose.  
Die 2-Jahres-Revisionsrate lag  
durchschnittlich bei 3.4%.

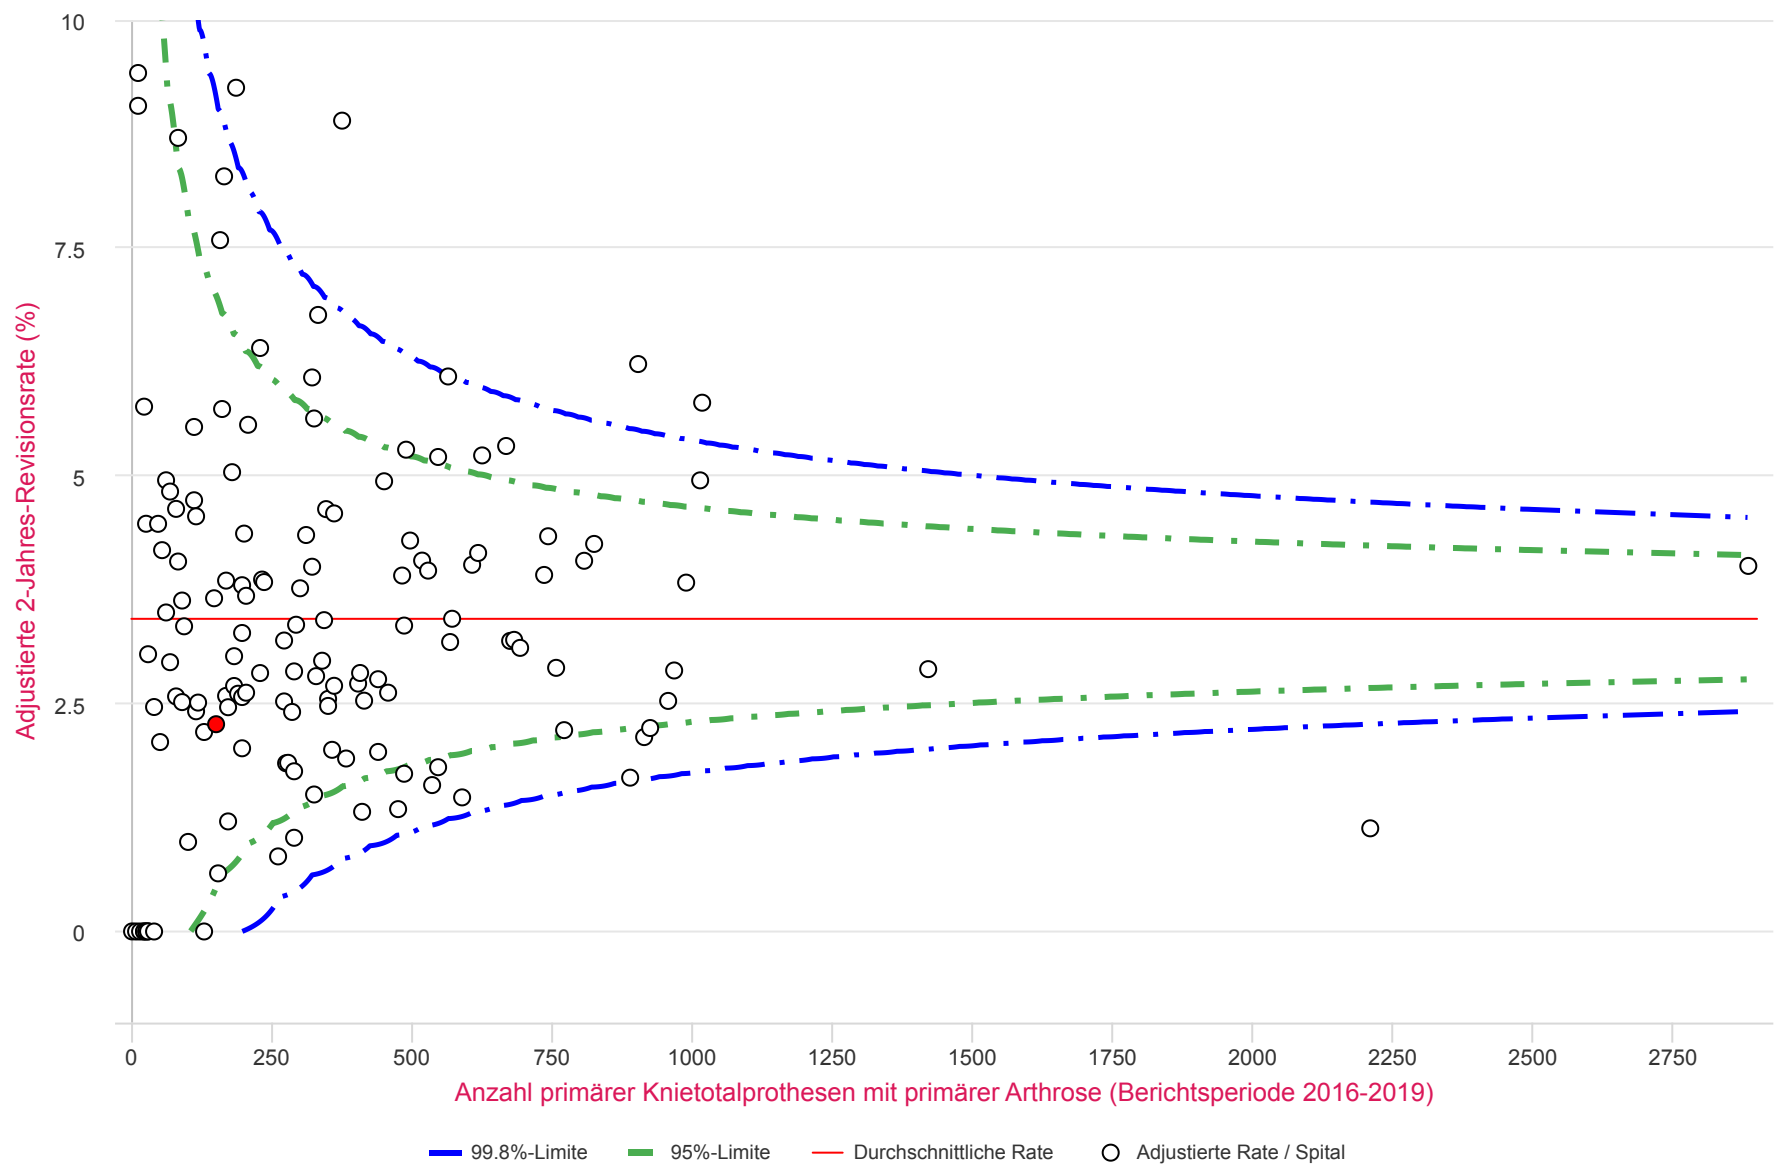

Anzahl primärer Knie totalprothesen mit primärer Arthrose (Berichtsperiode 2016-2019)

— 99.8%-Limite    - - 95%-Limite    — Durchschnittliche Rate    ○ Adjustierte Rate / Spital